


Software opdatering

AudioConsole 4.4.0



For at forbedre persondatasikkerheden, når sundhedsplejen laver høretest, har Oscilla i samarbejde med Novax lavet en forbedret kryptering (AES-256) af de data, der udveksles mellem Oscilla software (AudioConsole) og Novax.

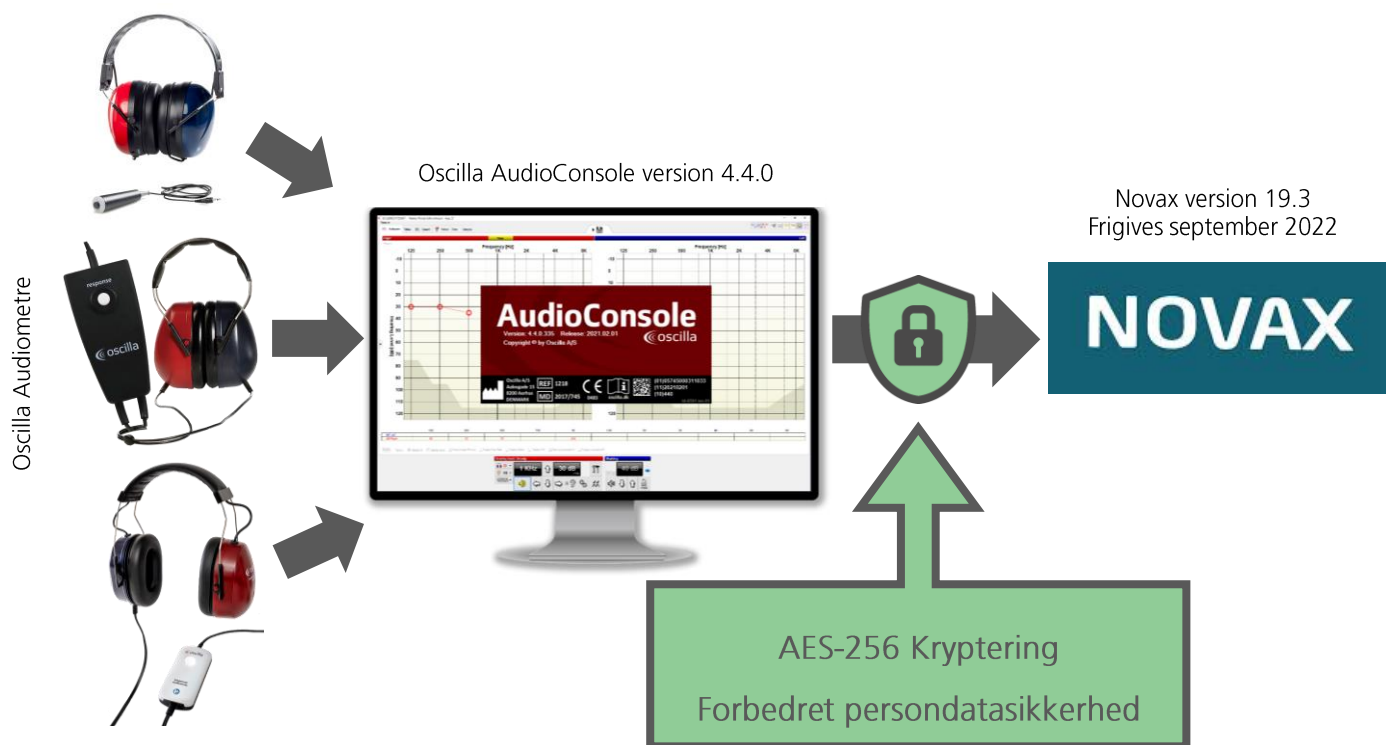

I september 2022 kommer Novax med en opdatering, version 19.3, som understøtter det nye krypterede interface. De kommuner, der benytter Oscilla sammen med Novax, og som endnu ikke har opdateret deres Oscilla software til version 4.4.0, bør derfor kontakte Oscilla A/S, så dette kan sættes i værk. Det er gratis for vores kunder at opdatere.

Den nye version af Oscilla softwaren lever op til den nye lovgivning for medicinsk udstyr og software, se mere på lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

<https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/nye-eu-regler-om-medicinsk-udstyr-skal-styrke-patientsikkerheden/>

Kontakt Oscilla på: info@oscilla.dk eller telefon: 61 72 81 70

Hvis kommunen mangler nye audiometre, har vi de nye Oscilla A30 audiometre til en god pris. Det er gratis at få et audiometer på prøve.

